FLOWTENS

LEAD THE FLOW

Neurostimulation Tibiale Postérieure Transcutanée

Mise en place de FLOWTENS

Flowtens s'utilise au choix :
· soit le **patch**
· soit avec la **chevillère**

Flowtens avec le patch

Clipsez le stimulateur sur la face exterieure



Clipsez les électrodes puis retirez le film de protection

Positionnez le patch en arrière et en dessous de la malléole interne (le positionnement peut se faire sur votre jambe droite ou gauche selon votre choix)

Flowtens avec la chevillère

Clipsez le stimulateur sur la face extérieure



Clipsez les électrodes à l'intérieur puis retirez le film

Vérifiez la chevillère
R : Pied droit
L : Pied Gauche



Positionnez le pied. Les zones en rouge indiquent le positionnement optimal des électrodes lors de la fermeture de la chevillère



Rabattez les scratchs en vous assurant du bon positionnement des électrodes par rapport à la malléole interne



Cet indicateur doit se trouver sur votre malléole interne

Application smartphone

Personnalisable & programmable

Digitale & connectée

Simple & ergonomique

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

Références

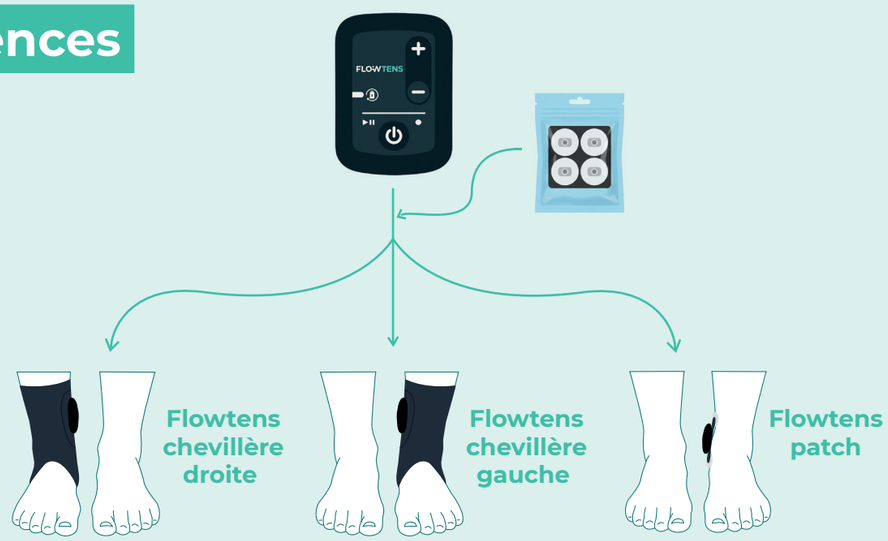

	Dénomination	Réf	GTIN
	Stimulateur* (livré avec une boite de transport et un câble de recharge)	FLO-02-201	3770025687049
	Chevillère droite x1	FLO-02-108-R	3770025687025
	Chevillère gauche x1	FLO-02-108-L	3770025687032
	Patch x1	FLO-02-109	3770025687094
	Electrodes auto-adhérentes**	SAE-SC050000 WP-VT	UDI (01)04719872332183 (11)YYMMDD (10)YYWW
	Boite de transport	FLO-07-103	3770025687100
	Câble de recharge	FLO-05-101	3770025687056

***Code 1111701** - LOCATION HEBDOMADAIRE
Code 6163358 - ACHAT d'un dispositif Flowtens
****Code 6154951** ou forfait annuel **code 1183014**

Programmes disponibles

Programme 10Hz

20	10	200
min	Hz	µs

Programme 14Hz

20	14	210
min	Hz	µs

Programme 20Hz

20	20	200
min	Hz	µs

Programme 25Hz

20	25	210
min	Hz	µs

Programme 5Hz

20	5	210
min	Hz	µs

Programme libre

0 à 120	0 à 50	0 à 600
min	Hz	µs

(code d'accés : 1234)

Courant de sortie (ajustable) :
0 à 50mA* (+/-5% de la valeur max)
* Sur résistance 1000 Ohm (+/-10%)

Largeur d'impulsion (ajustable) :
50 à 600µs (+/-10%)

Fréquence d'impulsion (ajustable) :
1 à 50Hz (+/-10%)

Durée du programme (ajustable) :
1 à 120min

Consommation en fonctionnement :
< 0.1W

Alimentation :
Batterie rechargeable
Lithium-ion Polymer 3.7V

Caractéristiques RF :
· Bluetooth® LE : 2400-2483.5 MHz (ISM)
· Modulation : GFSK
· Puissance émission : -4.7 dBm
· Espacement et nombre de canaux :
1 MHz, 40 canaux
· Type d'antenne :
Céramique gain 0.5 dBi

Dimensions :
60 mm x 44 mm x 18 mm

Masse :
30g

Service client :
· Pour passer commande :
order@flowtens.com
· Pour toute question ou réclamation :
contact@flowtens.com
Tél : 09 78 45 27 74

www.flowtens.com
Conçu, fabriqué et distribué par FlowStim Technology, France
Pôle Economique - 1010 Av de l'Europe
33260 La Teste de Buch

FlowStim TECHNOLOGY

Distribué en Suisse par:

PARIMED
FOR BETTER LIVES

Parimed GmbH
Unter Sagi 6
CH-6362 Stansstad
Schweiz

Tel. +41 (0)41 312 11 11
www.parimed.ch

Version DI-016-MKT-V001
Mise en page : Laure Pécault