FLOWTENS

LEAD THE FLOW

Transkutane posteriore Tibiastimulation (T-PTNS)

Anlegen von FLOWTENS

Flowtens kann flexibel wie folgt angewendet werden:
· oder mit dem **Patch**
· entweder mit der **Knöchelbandage**

Flowtens mit dem Patch

Clipsen Sie den Stimulator auf die Außenseite



Clipsen Sie die Elektroden fest und ziehen Sie anschließend die Schutzfolie ab

Positionieren Sie das Patch hinter und unterhalb des Innenknöchels (die Positionierung kann nach Wahl am rechten oder linken Bein erfolgen)

Flowtens mit der Knöchelbandage

Clipsen Sie den Stimulator auf die Außenseite

Clipsen Sie die Elektroden auf die Innenseite und ziehen Sie anschließend die Folie ab

Überprüfen Sie die Knöchelbandage:
R: Rechter Fuß
L: Linker Fuß



Positionieren Sie den Fuß und schließen Sie die Klettverschlüsse. Die roten Bereiche markieren die optimale Positionierung der Elektroden im Verhältnis zum Innenknöchel beim Schließen der Knöchelbandage.



Positionieren Sie den Fuß und schließen Sie die Klettverschlüsse. Die Bereiche markieren die optimale Positionierung der Elektroden im Verhältnis zum Innenknöchel beim Schließen der Knöchelbandage.



Dieser Indikator muss sich auf Ihrem Innenknöchel befinden

Die mobile app

Individuell anpassbar & programmierbar

Digital & connected

Benutzerfreundlich & ergonomisch

Verfügbar bei Google Play

Laden im Apple Store

Zubehör

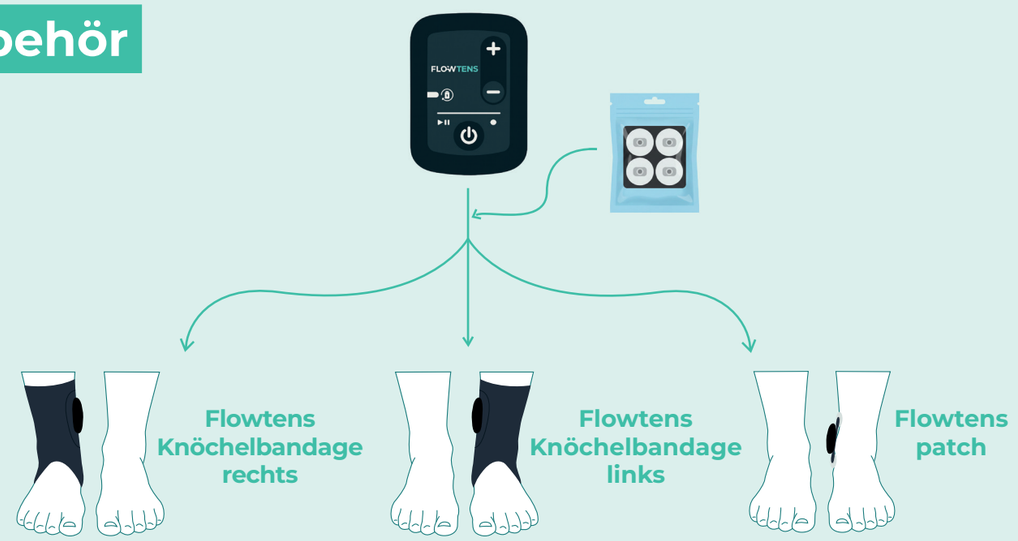

	Beschreibung	Ref.	GTIN
	Stimulator* (Geliefert mit einer Transportbox und einem Ladekabel)	FLO-02-201	3770025687049
	Knöchelbandage rechts x1	FLO-02-108-R	3770025687025
	Knöchelbandage links x1	FLO-02-108-L	3770025687032
	Patch x1	FLO-02-109	3770025687094
	Flowtens Selbstklebende Elektroden	SAE-SC050000 WP-VT	UDI (01)04719872332183 (11)YYMMDD (10)YYWW
	Transportbox	FLO-07-103	3770025687100
	Ladekabel	FLO-05-101	3770025687056

Therapieprogramm auswählen

Programm 10Hz

20	10	200
min	Hz	µs

Programm 14Hz

20	14	210
min	Hz	µs

Programm 20Hz

20	20	200
min	Hz	µs

Programm 25Hz

20	25	210
min	Hz	µs

Programm 5Hz

20	5	210
min	Hz	µs

maßgeschneidertes Programm

0 bis 120	**0 bis 50**	**0 bis 600**
min	Hz	µs

(Zugangskode: 1234)

Ausgangsleitstung (erstellbar):
0 bis 50mA* (+/-5% des Maximalwertes)
* Auf 1000 Ohm Widerstand (+/-10%)

Impulsbreite (erstellbar):
50 bis 600µs (+/-10%)

Frequenzbereich (erstellbar):
1 bis 50Hz (+/-10%)

Programmlaufzeit (erstellbar):
1 bis 120 Min.

Stromverbrauch im Betrieb:
< 0.1W

Stromversorgung:
Wiederaufl adbarer Akku
Lithium-Ionen Polymer 3.7V

Hochfrequenzeigenschaften:
· Bluetooth® LE: 2400-2483,5 MHz (ISM)
· Modulation: GFSK
· Sendeleistung: -4.7 dBm
· Abstand und Anzahl der Kanäle: 1 MHz, 40 Kanäle
· Antennentyp: Keramik 0.5 dBi

Abmessungen:
60 mm x 44 mm x 18 mm

Masse:
30g

Kundendienst:
· Für Bestellungen:
order@flowtens.com
· oder kontaktieren Sie uns:
contact@flowtens.com
+33 9 78 45 27 74

www.flowtens.com
Entwickelt, hergestellt und vertrieben durch Flowstum Technology France
Pôle Economique - 1010 Av de l'Europe
33260 La Teste de Buch

FlowStim TECHNOLOGY

In der Schweiz vertrieben von:

PARIMED
FOR BETTER LIVES

Parimed GmbH
Unter Sagi 6
CH-6362 Stansstad
Schweiz

Tel. +41 (0)41 312 11 11
www.parimed.ch

Version DI-016-MKT-V001
Marketing: Laure Pécault